

Эрекционное кольцо We-Vibe Pivot

Руководство пользователя





Тип товара: Эрекционное кольцо-вибратор

Характеристики

Материал: медицинский силикон

Размеры: 80 x 32 x 42 мм

Время полной зарядки: 1,5 часа

Время автономной работы: до 2 часов


Используемое ПО: We-Connect


Совместимость: iOS 8.0 / Android 4.4

Размеры упаковки: ~85 x 100 x 105 мм

Вес в упаковке: ~300 г

Страна-разработчик: Канада

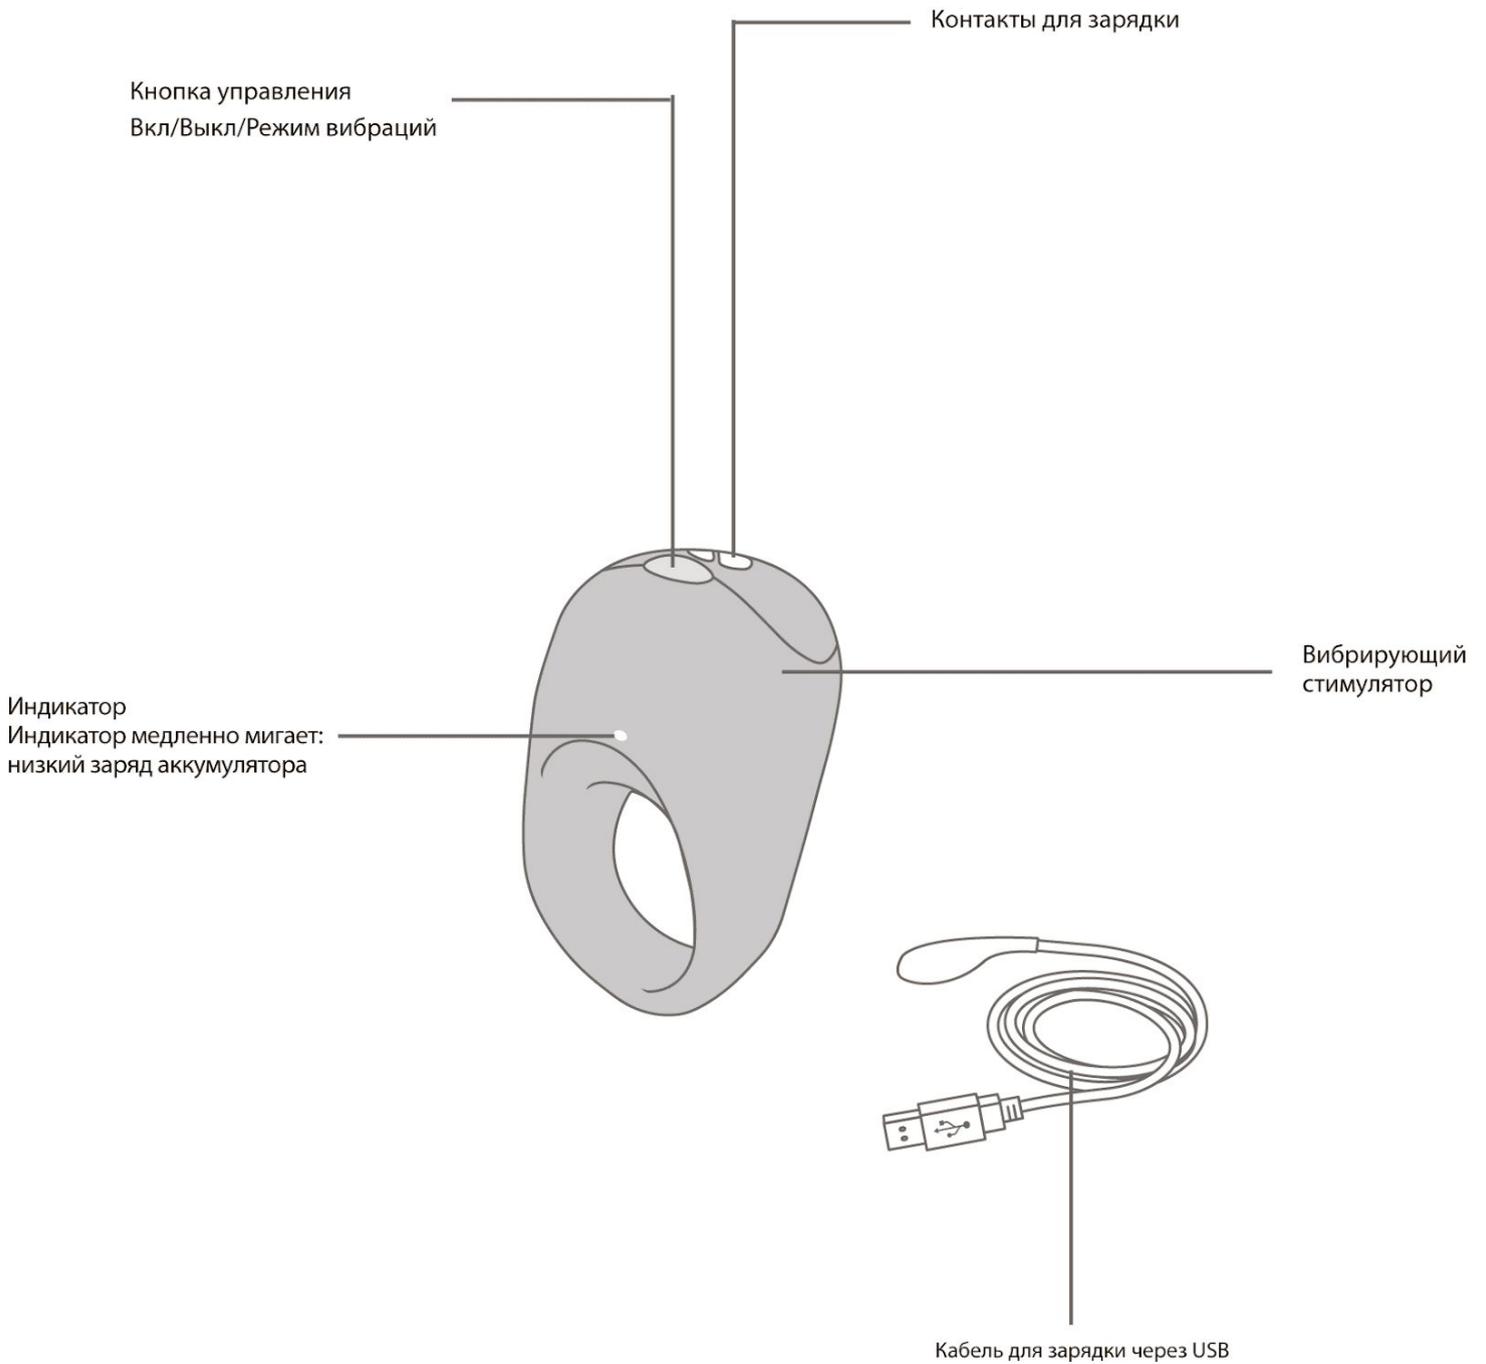

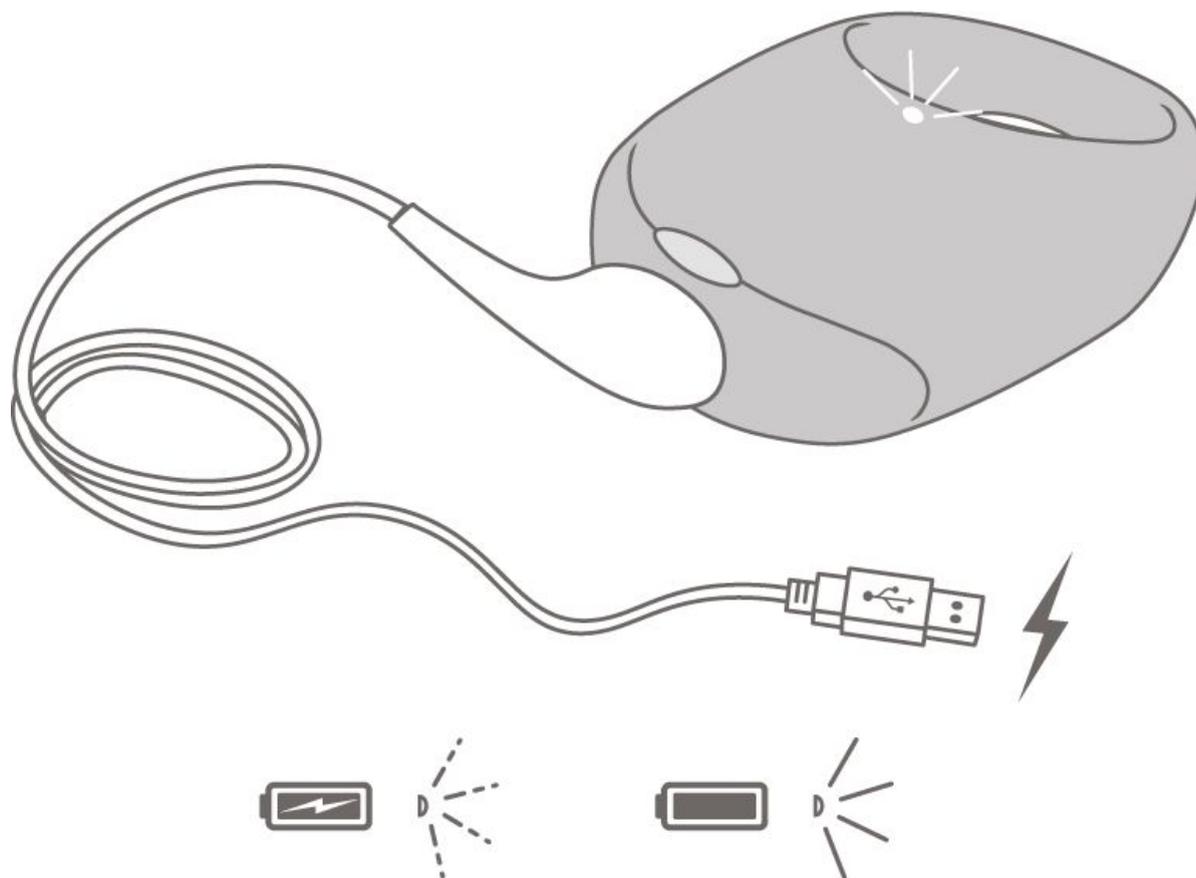


1

Заряжайте устройство в течение 90 минут.

Индикатор быстро мигает: устройство заряжается


Индикатор горит, не мигая: устройство полностью заряжено

Индикатор не горит: нет питания или плохо подключен
кабель для зарядки

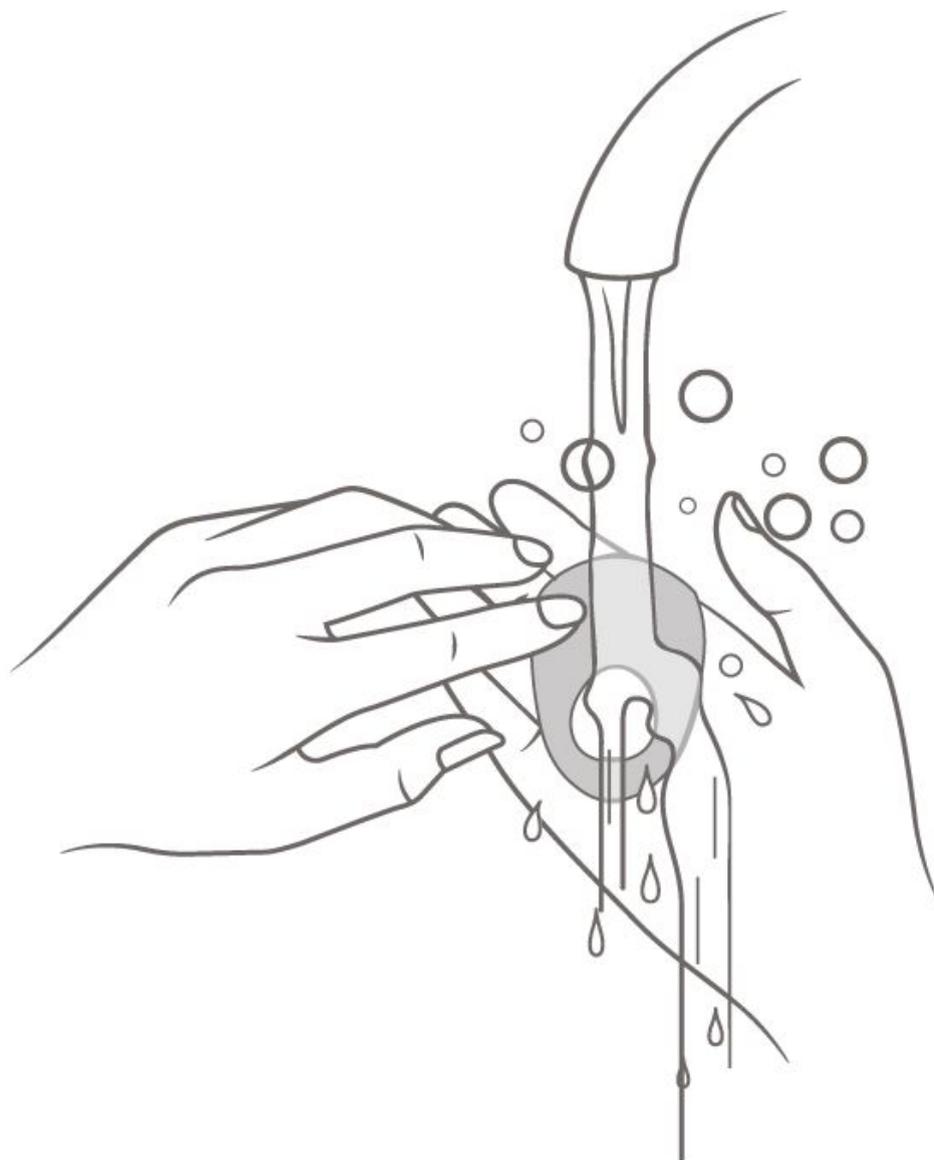


2

Вымойте вибратор средством We-Vibe™ Clean – made by rJUR® или водой с мылом.

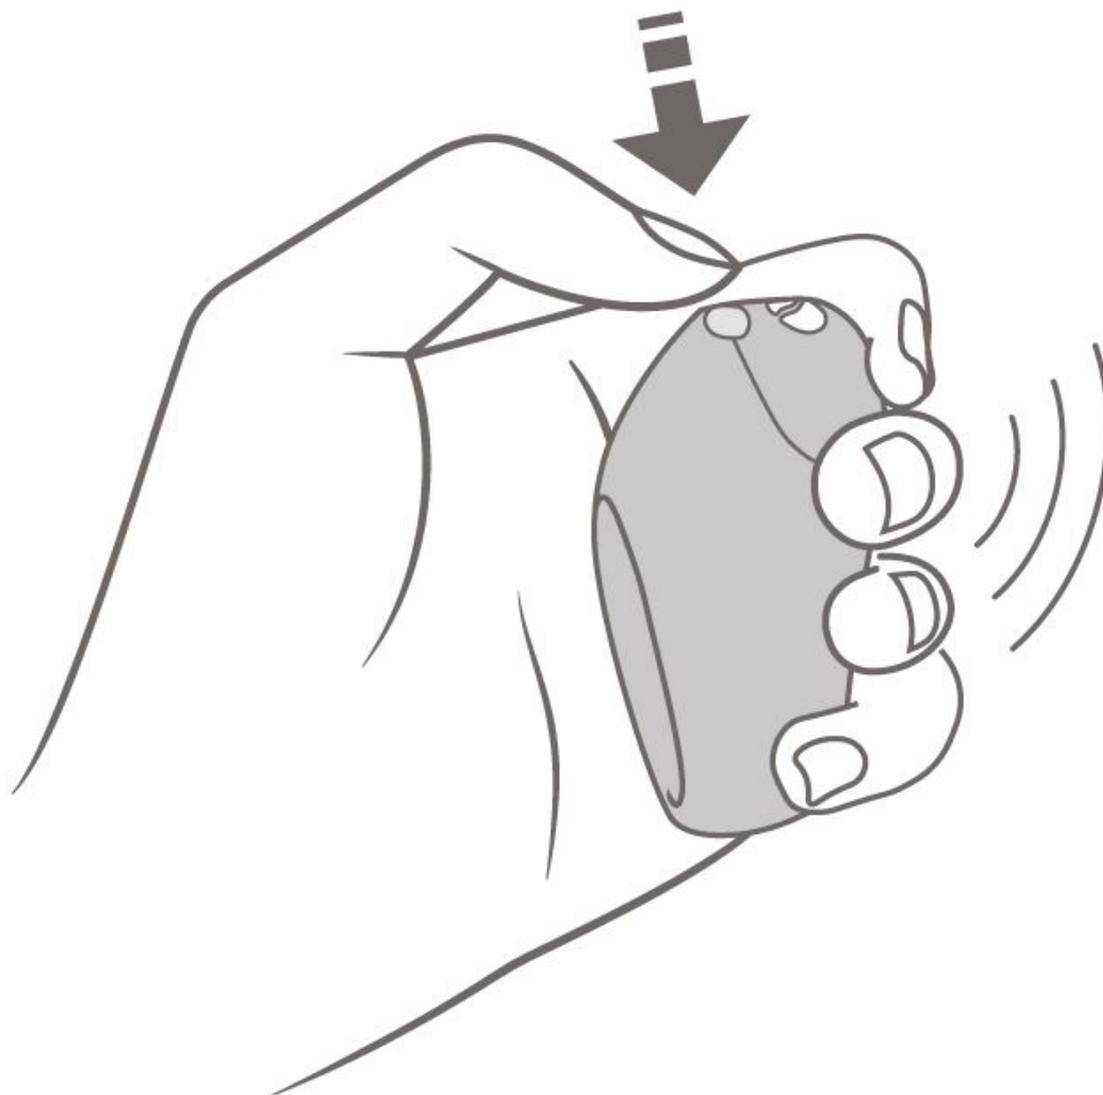


3

Для включения стимулятора Pivot by We-Vibe™ нажмите кнопку управления. Для изменения режима вибрации снова нажмите кнопку управления.

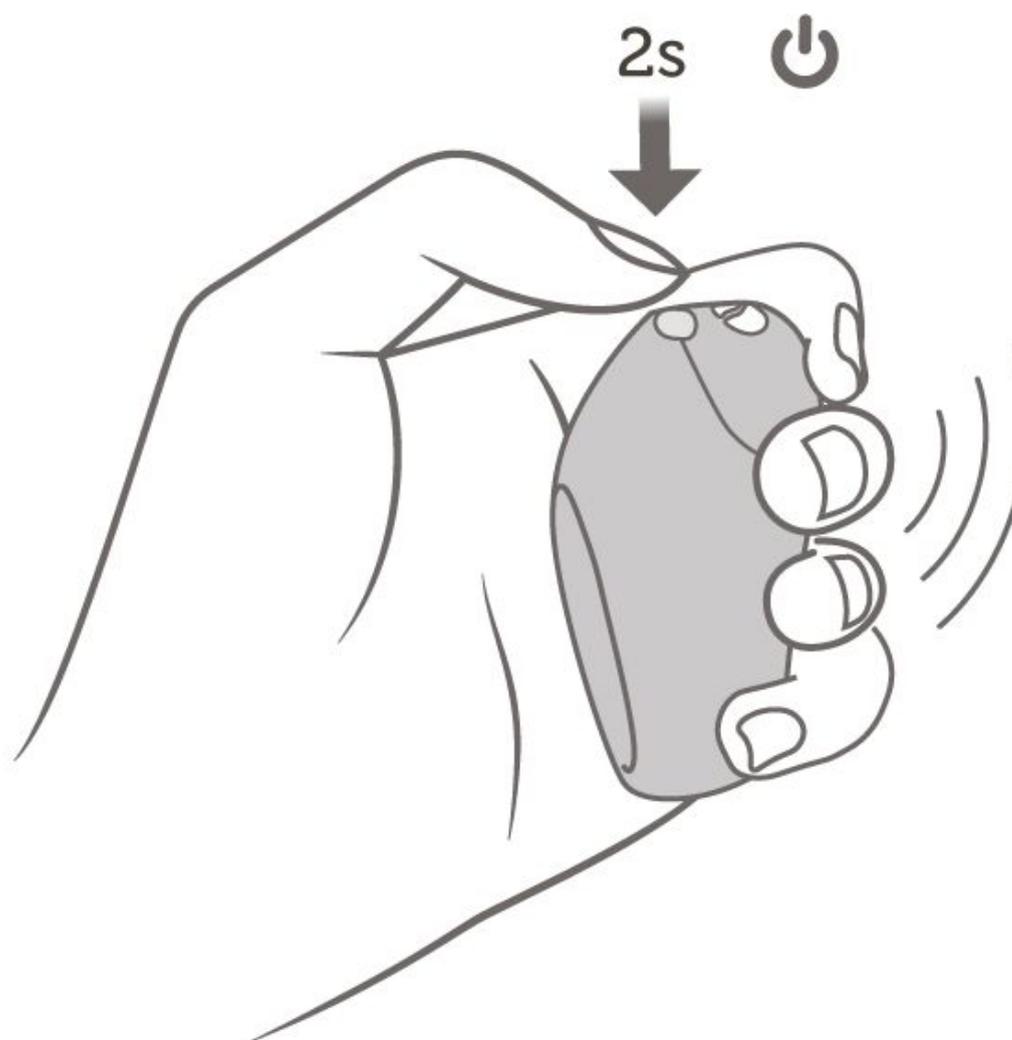


4

Для выключения стимулятора Pivot нажмите и удерживайте кнопку управления в течение 2 секунд.

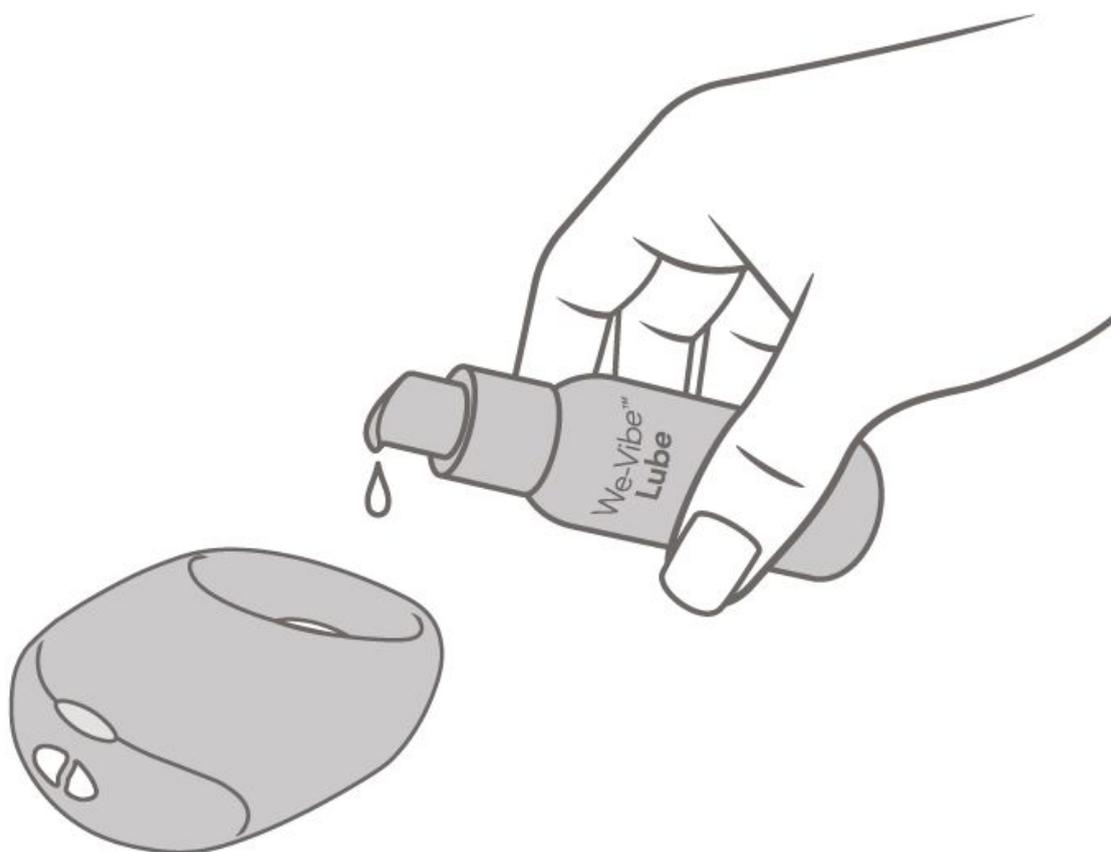


5

Нанесите на внутреннюю поверхность кольца небольшое количество смазки We-Vibe™ Lube – made by pjur® или другого лубриканта на водной основе.

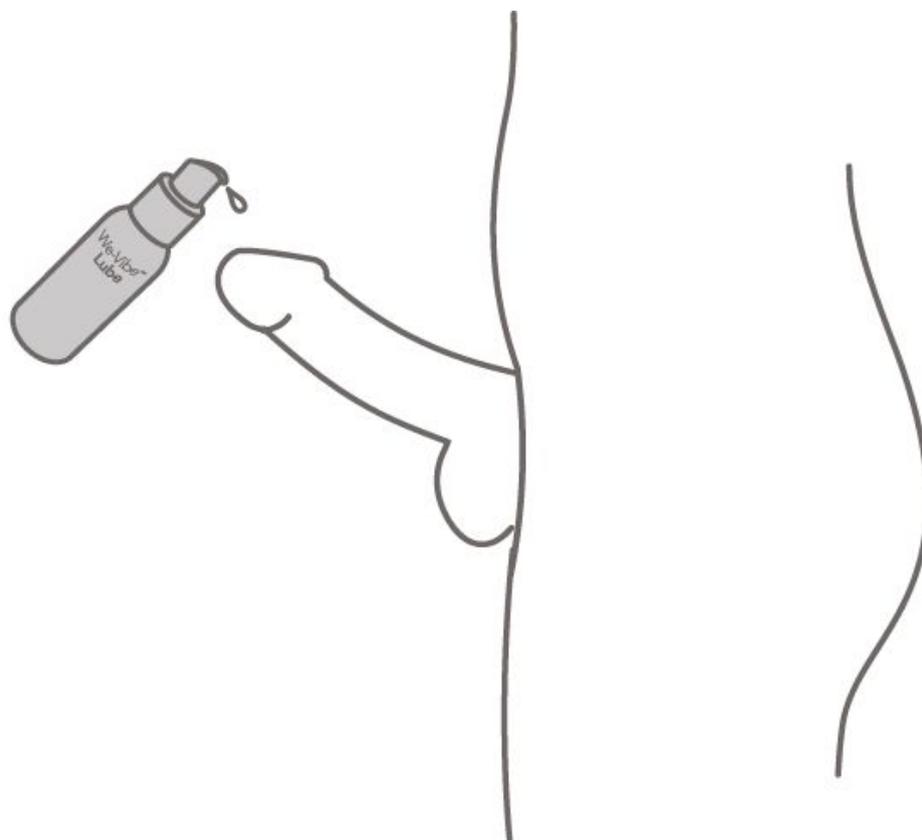

6

Нанесите небольшое количество смазки на водной основе на пенис. Растяните кольцо вокруг головки и спустите его вниз к основанию.

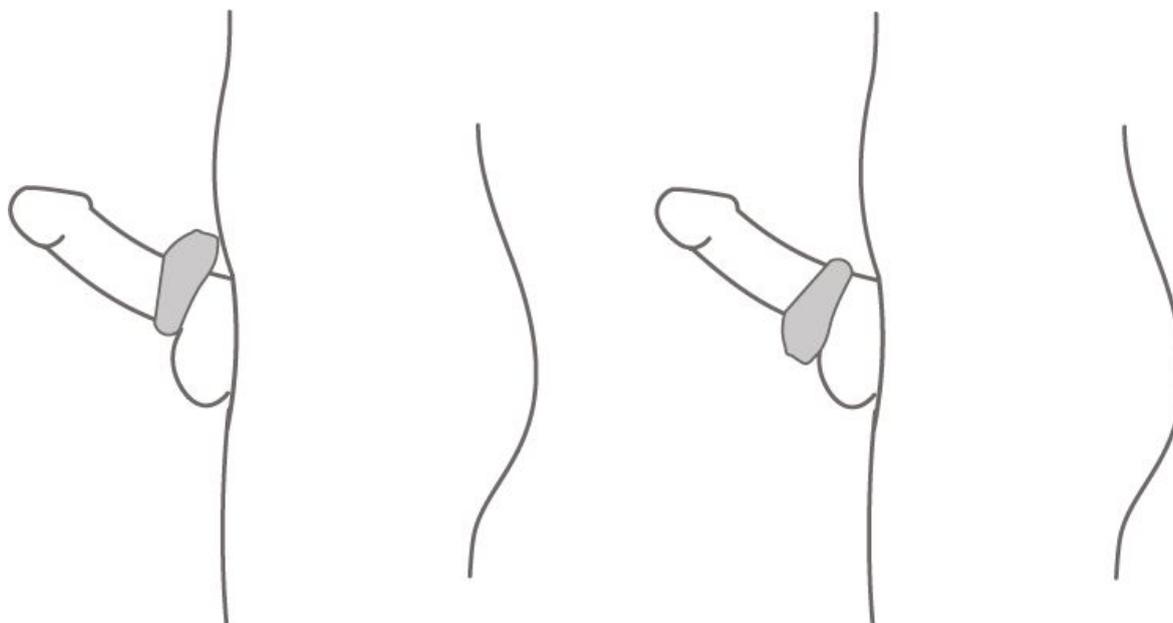



7

Стимулятор Pivot можно носить по-разному. Найдите удобное для вас положение.



8

Выберите ваш любимый режим и наслаждайтесь стимулятором Pivot самостоятельно или с партнером.

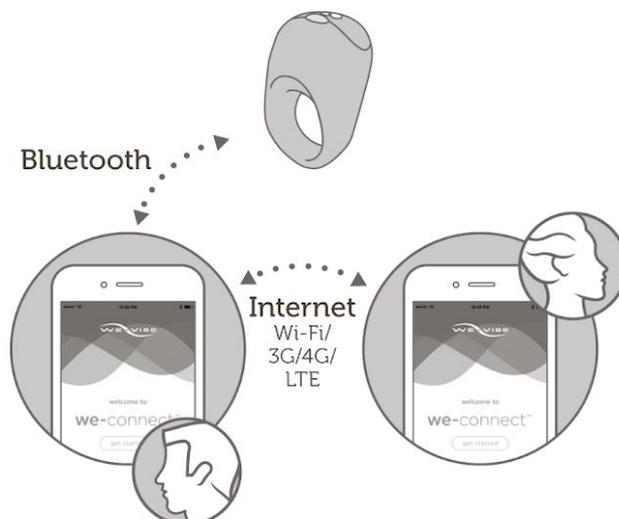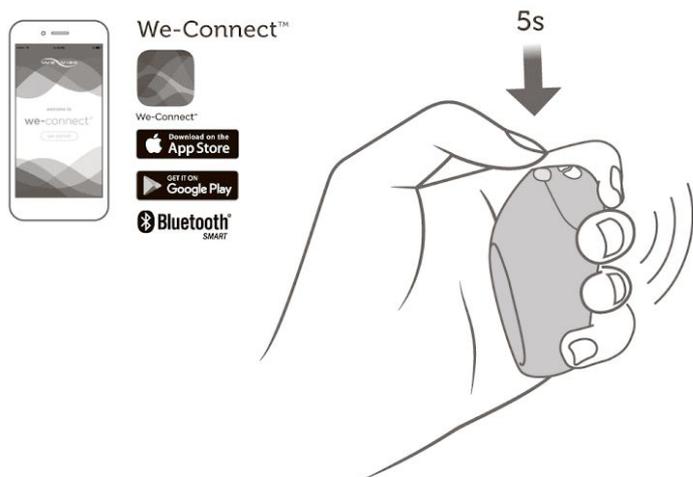

СИНХРОНИЗИРУЙТЕ СТИМУЛЯТОР PIVOT BY WE-VIBE™ С ПРИЛОЖЕНИЕМ WE-CONNECT™

Установите приложение We-Connect™ на свой смартфон. Откройте приложение и следуйте инструкциям на экране для синхронизации устройства. Для выполнения синхронизации нажмите и удерживайте кнопку управления на стимуляторе Pivot в течение 5 секунд до тех пор, пока Pivot дважды не пропульсирует. Для сексуальной игры на расстоянии после синхронизации отправьте своему партнеру приглашение, выбрав в меню приложения опцию «подключить партнера».

Дополнительная информация представлена на веб-сайте we-vibe.com/app.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАРЯДКА СТИМУЛЯТОРА

- Полная зарядка занимает до 2 часов в зависимости от оставшегося заряда аккумулятора стимулятора Pivot by We-Vibe™.
- Чтобы зарядить аккумулятор, не нужно ждать, пока он полностью разрядится.
- При использовании компьютерного разъема USB зарядка стимулятора Pivot не будет выполняться, если компьютер находится в режиме пониженного энергопотребления.
- Для зарядки стимулятора можно использовать любой блок питания USB.
- При хранении стимулятора Pivot заряд сохраняется на протяжении нескольких месяцев и постепенно уменьшается с течением времени. Для эффективного использования и удлинения срока службы аккумулятора подзаряжайте устройство до того, как вибрации ослабнут.
- Стимулятор Pivot не заряжается при слишком высокой температуре (+45 °C). Зарядка Pivot начинается автоматически, после того как температура стимулятора достигает безопасного значения.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

- Не используйте лубриканты на силиконовой основе, потому что они могут повредить изделие.
- Не очищайте устройство веществами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
- Не помещайте стимулятор Pivot в кипящую воду, духовку, микроволновую печь или посудомоечную машину.
- Не храните устройство при экстремальных температурах.
- Не заряжайте стимулятор возле воды.

ГАРАНТИЯ

Двухлетняя гарантия покрывает только замену изделия при наличии производственных дефектов. Информация о замене изделия и гарантии представлена на веб-сайте we-vibe.com/warranty. Никакие другие явные или подразумеваемые гарантии предоставляются. При наличии претензий по гарантийным обязательствам или любого другого повреждения, единственным средством защиты пользователя является замена изделия. Использование данного изделия не предполагает и не гарантирует каких-либо медицинских свойств.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Устройство Pivot by We-Vibe™ следует использовать внутри помещений при температуре +10 °C до +45 °C.

Данное цифровое устройство класса В соответствует канадскому стандарту ICES-003.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC и стандартам RSS Министерства промышленности Канады в отношении нелицензируемых изделий. Данное устройство работает с учетом следующих двух характеристик: (1) данное устройство не вызывает вредных помех, и (2) данное устройство принимает все помехи, включая помехи которые могут вызвать нежелательные сбои в работе устройства.

Данное изделие соответствует основным требованиям Директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 2011/65/EU и 1999/5/EC.

Pivot by We-Vibe™: модель 6000-02. Содержит FCC ID: ZUE6000 IC: 9804A-6000

Изменения или модификации, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного оборудования. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт we-vibe.com/support/regulatory-compliance.

ОТВЕТСТВЕННАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии указывает, что этот продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Электрическое и электронное оборудование содержит опасные вещества, которые могут быть вредными для окружающей среды и здоровья человека, если их не утилизировать должным образом. Для уменьшения воздействия на окружающую среду рекомендуется использовать соответствующие системы для возврата устройств после окончания срока службы изделия. Для получения подробной информации обратитесь в местную или областную администрацию по отходам.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об экологических характеристиках нашей продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Во избежание поражения электрическим током запрещается пользоваться зарядным устройством рядом с водой. Не используйте устройство на опухших или воспаленных участках кожи. В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства. Не используйте устройство в области шеи. На ваше оригинальное изделие We-Vibe® предоставляется двухлетняя гарантия. Зарегистрируйтесь на веб-сайте we-vibe.com/register.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вибрирующие кольца для пениса We-Vibe® предназначены для расширения сексуального опыта.

Кольца для пениса можно использовать непрерывно максимум в течение 30 минут. Длительное использование устройства (без перерыва) может привести к необратимому повреждению пениса. Сделайте 60-минутный перерыв перед следующим использованием.

Неправильное использование кольца для пениса может привести к кровоподтекам, серьезной травме пениса, мошонки и/или яичек.

Если вы испытываете дискомфорт или боль во время использования изделия в возбужденном состоянии, прекратите сексуальную активность и избегайте сексуального возбуждения для прекращения эрекции перед снятием кольца. Снятие кольца для пениса в эрегированном состоянии может привести к кровоподтекам, серьезной травме пениса, мошонки и/или яичек.

Прекратите использование изделия, если вы чувствуете холод в гениталиях или испытываете неприятные ощущения в области пениса, включая раздражение, отек, боль или потерю чувствительности. Обратитесь к врачу, если ощущения сохраняются после снятия кольца.

Не спите с надетым кольцом для пениса, так как длительное использование изделия может привести к необратимому повреждению пениса, мошонки и/или яичек.

Не используйте кольца для пениса в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поскольку в таком состоянии вы можете быть неспособны принимать здравые решения, и риск получения травмы увеличивается.

Не используйте кольца для пениса, если у вас снижена болевая чувствительность в любой части пениса, так как вы можете не обнаружить возможную травму.

Не используйте устройство, если у вас слабые мышцы рук, поскольку вы можете столкнуться с трудностями при снятии устройства.

Не делайте массаж отекающих или воспаленных участков тела или участков, где повреждена кожа.

Перед использованием проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть следующие заболевания: нарушение свертывания крови, болезнь периферических сосудов, диабет или заболевание нервной системы. Не используйте вибрирующее кольцо, не проконсультировавшись со своим врачом.

Проконсультируйтесь с врачом перед использованием изделия, если вы принимаете препараты для разжижения крови.



Если у вас есть симптомы эректильной дисфункции и вы не можете достичь эрекции, достаточной для полового акта, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого устройства, чтобы избежать потенциально опасных задержек диагностики любой из наиболее распространенных причин этого заболевания, включая сахарный диабет, рассеянный склероз, цирроз печени, хроническую почечную недостаточность или алкоголизм.

Использование колец для пениса может усугубить существующие заболевания, включая болезнь Пейрони (образование затвердевшей ткани в половом члене, которая вызывает боль, искривление и деформацию, как правило, во время эрекции), приапизм (стойкую, обычно болезненную эрекцию полового члена вследствие заболевания, не связанную с сексуальным возбуждением) и стриктуру уретры (стриктура уретры представляет собой участок затвердевшей ткани, из-за которой сужается уретра и иногда затрудняется мочеиспускание.)

Использование устройства может привести к ушибам или разрыву кровеносных сосудов в половом члене или мошонке, что приводит к петехии (небольшое пурпурное пятно на поверхности тела, например, на коже или слизистой оболочке, возникающее в результате моментального кровоизлияния) или образованию гематомы (локальная припухлость, наполненная кровью в результате разрыва кровеносного сосуда).

Пожалуйста, прекратите использование изделия и обратитесь к врачу, если вы или ваш партнер испытываете какие-либо осложнения, связанные с этим устройством.

Кольца для пениса не защищают от беременности или инфекций, передающихся половым путем.

Если у вас есть опасения по поводу вашего здоровья, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого устройства.

Комплектация

- We-Vibe Pivot
- Зарядный кабель
- Документация